

CE



mouse in basic

Instrukcja obsługi i konserwacji

Edycja 2/2022-11-15

Wózek inwalidzki specjalny MOUSE in.basic



UWAGA! Użytkownik z niesprawnością widzenia, czytania lub niesprawnością poznawczą proszony jest o zgłoszenie się do Producenta w celu uzyskania informacji dla użytkownika w odpowiednim formacie.

Przeznaczenie Instrukcji

Instrukcja obsługi i konserwacji zawiera podstawowe informacje niezbędne dla prawidłowego użytkownika wózka inwalidzkiego MOUSE in.basic, w tym zasady bezpieczeństwa jego użytkowania, opis jego budowy, obsługi i regulacji, przygotowania wózka do pracy, sposobu konserwacji i czyszczenia wózka oraz warunków gwarancji.

Przeznaczona jest dla osób sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi (asystentów dziecka - rodziców, opiekunów), które będą przewożone w wózku. Przeznaczona jest również dla lekarzy i rehabilitantów obsługujących wózki.

UWAGA! Przed przystąpieniem do użytkowania wózka, każdy Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszej instrukcji i stosowania się do niej.

Niniejsza instrukcja jest nieodłączną częścią produktu i każdorazowo musi być dołączona do sprzedawanego produktu. **Zachowaj niniejszą instrukcję na przyszłość!** Instrukcję należy przechowywać w łatwo dostępnym miejscu. Instrukcja w wersji elektronicznej znajduje się na stronie internetowej www.mywam.eu

UWAGA! W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek incydentu medycznego związanego z obecnością wózka inwalidzkiego MOUSE in.basic, należy niezwłocznie, pisemnie powiadomić o tym Producenta, kontaktując się poprzez list polecony lub e-mail za potwierdzeniem odbioru.

Dane kontaktowe producenta:

- adres pocztowy: MyWam sp.j., ul. Szczecińska 10, 41-516 Chorzów, Polska
- numer telefonu kontaktowego: +48 32 733 11 31
- adres e-mail: mywam@mywam.pl



Wersja Instrukcji obsługi i konserwacji: PL **Edycja 2/2022-11-15**

MyWam Kupiec, Bartold, Angres Sp.J. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i handlowych w treści Instrukcji obsługi i konserwacji bez wcześniejszego uprzedzenia. Każda zmiana zostanie określona datą ostatniej aktualizacji instrukcji.

Spis treści

▪ Wprowadzenie	5
1. Przeznaczenie i wskazania do stosowania wózka MOUSE in.basic	5
2. Podstawowe informacje o wózku MOUSE in.basic	5
▪ Bezpieczeństwo	6
3. Ważne wskazówki i zasady bezpieczeństwa	6
4. Tabliczki	7
4.1. Tabliczka znamionowa	7
4.2. Tabliczka z kodem UDI	7
5. Tablice ostrzegawcze	7
6. Oznaczenie symboli	8
▪ Produkt	9
7. Ogólna budowa wózka	9
8. Konfiguracja i użytkowanie – rama wózka	9
8.1. Rozkładanie ramy wózka	9
8.2. Składanie ramy. Blokada transportowa	11
8.3. Koła skrętne oraz indywidualne hamulce	11
8.4. Ergonomiczna rączka do pchania wózka. Mechanizm i regulacja kątowa rączki.	12
8.5. Podnózek. Regulacja i użytkowanie.	12
9. Konfiguracja i użytkowanie -siedzisko terapeutyczne z oparciem na plecy	13
9.1. Montaż i demontaż siedziska do ramy	13
9.2. Regulacja wysokości	14
9.3. Regulowane siedzisko, tzw. "kołyska"	15
9.4. Regulowane oparcie	15
10. Wyposażenie podstawowe	16
10.1. Pasy pięciopunktowe	16
10.2. Barierka zabezpieczająca	16
10.3. Regulowany daszek z okienkiem	17
10.4. Pasy odwodząco-stabilizujące	17
10.5. Klin	18
10.6. Wkładki wyścielające	18
10.7. Tapicerka	18
11. Wyposażenie dodatkowe	18
11.1. Peloty zagłówka z regulacją ↔ oraz ↕	18
11.2. Peloty piersiowo-lędźwiowe z regulacją ↔ oraz ↕	18
11.3. Stolik terapeutyczny	19
11.4. Wkładki zwężająco-sptycające	19
11.5. Moskitiera	20
12. Specyfikacja techniczna wózka MOUSE in.basic	20
12.1. Skład surowcowy wózka	20
13. Dostawa i narzędzia	21
14. Montaż i demontaż wózka	21
15. Przygotowanie do użytkowania	21
16. Użytkowanie wózka	22

16.1.	Przenoszenie wózka	22
16.2.	Wsiadanie i zsiadanie z wózka inwalidzkiego	23
16.3.	Prawidłowa pozycja w wózku inwalidzkim	23
16.4.	Jazda na wózku inwalidzkim	23
16.5.	Pokonywanie progów	23
16.6.	Transport w samochodzie i w innych pojazdach	24
16.7.	Czyszczenie i pielęgnacja	24
17.	Przechowywanie wózka	25
17.1.	Przygotowanie wózka do długotrwałego przechowywania	25
17.2.	Zabezpieczenie antykorozyjne	25
18.	Powtórne użycie	25
19.	Serwis i przeglądy okresowe	26
20.	Utylizacja	27
21.	Zgodność z wymaganiami dotyczącymi wyrobów medycznych	28
22.	Notatki	29
23.	Lista autoryzowanych punktów serwisowych	30
24.	Karta Gwarancyjna	31

▪ Wprowadzenie

Dziękujemy Państwu za zakup wózka inwalidzkiego specjalnego **MOUSE in.basic**. Mamy nadzieję, że będzie on okazją do wielu wspianiałych chwil z Waszym dzieckiem i będzie pomocny każdego dnia. Dokładamy wszelkich starań by nasze produkty spełniały Wasze oczekiwania i najwyższe standardy. Zachęcamy do kontaktu z naszymi pracownikami oraz śledzenia nas na naszej stronie internetowej www.mywam.eu oraz w mediach społecznościowych. Możecie się tam dowiedzieć wielu ciekawych rzeczy o naszych produktach.

1. Przeznaczenie i wskazania do stosowania wózka **MOUSE in.basic**

MOUSE in.basic to zaprojektowany z myślą o dzieciach niepełnosprawnych wielofunkcyjny inwalidzki wózek. Dzięki swojej lekkiej, uproszczonej budowie sprawdza się w warunkach domowych i pomieszczeniach zamkniętych o stosunkowo równej powierzchni. Znacząco ułatwia wykonywanie czynności związanych z rehabilitacją oraz stanowi istotną pomoc w codziennym funkcjonowaniu. Wózek oparty jest na ramie wykonanej z elementów stalowych. MOUSE in.basic jest kompletnym systemem terapeutycznym umożliwiającym regulację kąta oparcia i podnóżka, długość podnóżka, pozycję zagłówka itp. Wyrób wyposażony jest w szereg akcesoriów poprawiających funkcjonalność i komfort użytkowania, takich jak np.: stolik, pasy zabezpieczające, klin, daszek, moskitiera itp. Użytkownicy nie mogą jeździć wózkiem samodzielnie, a jedynie z pomocą opiekuna. Wózek może być użytkowany wewnątrz pomieszczeń. Inne niż opisane stosowanie wyrobu jest zakazane. Wózek musi być używany wraz z instrukcją użytkowania, wyłącznie przez osoby dorosłe opiekujące się użytkownikiem. Młodzież i dzieci jak również wszelkie inne osoby bez odpowiedniego przeszkolenia nie powinny używać wyrobu.

Wózek inwalidzki MOUSE in.basic jest wyrobem medycznym klasy I wskazanym do używania przez te dzieci niepełnosprawne, które ze względu na swoje schorzenie nie mogą samodzielnie chodzić, stać lub siadać. Wyrób powinien być stosowany zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzącego lub fizjoterapeuty. Wyrób przeznaczony jest do transportu i przemieszczania powyższych osób w pozycji siedzącej lub leżącej oraz na korekcji postawy i na tym polega jego przewidziane zastosowanie.

Wskazania kliniczne to m.in. mózgowie porażenie dziecięce, przepuklina oponowo-rdzeniowa, dystrofie, niedowłady itp. Wyrób przewidziany jest dla użytkowników w wieku od 2 do 6 lat, o wzroście z przedziału od 80 do 110cm i wadze do 30kg.

Przeciwwskazania:

W przypadku przeciwwskazania do pozycji siedzącej i/lub pionizacji biernej regulację wózka należy skonsultować z fizjoterapeutą lub lekarzem prowadzącym.

2. Podstawowe informacje o wózku **MOUSE in.basic**

Wózek inwalidzki MOUSE in.basic posiada wiele możliwości regulacyjnych, np.:

- regulacja kąta pochylenia oparcia (patrz pkt 9.4)
- regulacji kąta siedziska-tzw. „Kotyska” (patrz pkt 9.3)
- regulacji głębokości siedziska- wkładki (patrz pkt 11.4)
- regulacji podnóżka (patrz pkt 8.5)
- regulacja pelot (patrz pkt 11.1 i 11.2)
- regulacja wysokości ramy (patrz pkt 9.2)
- wyposażenie dodatkowe (patrz pkt 11)

▪ **Bezpieczeństwo**

3. **Ważne wskazówki i zasady bezpieczeństwa**

- Zabrania się użytkowania wózka w sposób, do którego wózek nie jest przeznaczony.
- Produkt zawiera małe części, które mogą być niebezpieczne w przypadku połknięcia przez dziecko!
- Z uwagi na duże możliwości regulacyjne wózka, podczas regulacji kątowej siedziska i regulacji kątowej oparcia na plecy, istnieje możliwość ustawienia takiej pozycji, w której głowa dziecka znajdzie się poniżej linii miednicy. Zabronione jest stosowanie takiej pozycji, gdyż mogłoby to doprowadzić do niebezpieczeństwa zachłyśnięcia lub zakrztuszenia się dziecka.
- Zabrania się umieszczania na wózku dodatkowego ciężaru, co w szczególności dotyczy umieszczania dodatkowego ciężaru z tyłu oparcia np. plecaka lub torby. Może to spowodować przewrócenie wózka inwalidzkiego MOUSE in.basic i obrażenia użytkownika! Nie dotyczy oryginalnych akcesoriów dodatkowych dedykowanych do wózka MOUSE in.basic nieprzekraczających dopuszczalnego obciążenia. Wszystkie dodatkowe elementy mocowane do wózka wpływają na jego stabilność.
- UWAGA! W zależności od wykonanych regulacji wózka inwalidzkiego MOUSE in.basic - dotyczy ustawienia rączki do pchania wózka, regulacji wysokości oparcia, regulacji kątowej oparcia, regulacji głębokości siedziska, regulacji kątowej siedziska, regulacji kąta podnóżka oraz ustawienia podnóżka - to wózek ten może przekraczać zalecane maksymalne gabaryty.
- UWAGA! Przed każdorazowym użyciem wózka należy wykonać rozpisane poniżej czynności, a w przypadku nieprawidłowości nie wolno używać wózka. W takiej sytuacji zaleca się pilny kontakt ze Sprzedawcą i/lub Producentem w celu otrzymania porady.
- UWAGA! Zaleca się, aby niewielkie progi pokonywać tyłem. Inny sposób pokonywania progów może skutkować uszkodzeniem wózka.
- UWAGA! Podczas przejazdu przez drzwi lub podobne zwężenia, ograniczające kierunek jazdy wózka, należy upewnić się, czy po obu stronach wózka jest odpowiednia ilość miejsca, co zapobiega przytrzaśnięciu się dłoni lub innych części ciała, jak również zapobiega uszkodzeniu wózka.

OSTRZEŻENIE!

- Nigdy nie pozostawiaj dziecka bez opieki w wózku, ponieważ grozi to niebezpieczeństwem!
- Ten produkt nie nadaje się do biegania lub jazdy na tyżwach czy rolnach.
- Wózek nie jest przeznaczony jako siedzisko w pojeździe silnikowym.
- Uwaga na szczeliny i elementy ruchome – grozi zakleszczeniem.
- Nie przenosić wózka z dzieckiem.
- Wózek zapakowany jest w worek. Worek nie jest zabawką. Przechowywać poza zasięgiem niemowląt i małych dzieci. Nie nakładać na głowę. Niebezpieczeństwo uduszenia.



- UWAGA! Zabrania się użytkowania wózka, jeżeli stan techniczny wózka lub pojedynczego elementu wózka jest zły lub użytkownik ma do niego jakiegokolwiek wątpliwości, wózek jest uszkodzony lub istnieje tylko podejrzenie, że wystąpiło uszkodzenie lub działanie wózka nie jest prawidłowe. W takiej sytuacji zaleca się pilny kontakt ze Sprzedawcą i/lub Producentem w celu otrzymania porady.

4. Tabliczki

4.1. Tabliczka znamionowa

- Na tabliczce znamionowej znajdują się podstawowe informacje o produkcie: nazwa, model, numer seryjny (identyfikacyjny), maksymalne obciążenie, data produkcji, potwierdzenie o zgodności produktu dla wyrobów medycznych, ostrzeżenie o postępowaniu zgodnie z Instrukcją obsługi i konserwacji oraz dane producenta (patrz Zdj. 4.1).
- Tabliczka znamionowa znajduje się na belce poprzecznej z tyłu ramy wózka, po jej lewej stronie, przyklejona od góry.



Zdj. 4.1

4.2. Tabliczka z kodem UDI


Tabliczka z kodem UDI zawiera informację o produkcie: nazwa, model, kod UDI oraz dane producenta (Zdj. 4.2).



Zdj. 4.2





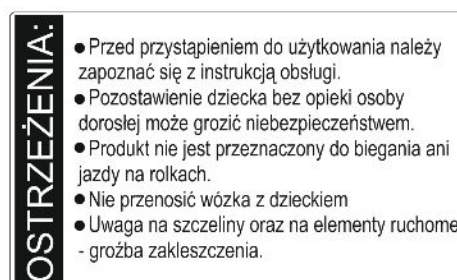



5. Tablice ostrzegawcze

- Na tabliczce ostrzegawczej znajdują się ważne ostrzeżenia dla użytkownika (patrz Zdj. 5.1).
- Tabliczka ostrzegawcza znajduje się na tylnej / bocznej części ramy, po obu stronach.



Zdj. 5.1

6. Oznaczenie symboli

	Numer seryjny produktu	 Nazwa producenta
	Dopuszczalny całkowity ciężar użytkownika	 Dany produkt jest wyrobem medycznym
	Data produkcji	OPIS " OSTRZEŻENIE! " i symbol w niniejszej instrukcji używane są w celu wzmocnienia uwagi osoby czytającej na treść oznaczoną tym znakiem.  Niestosowanie się do treści oznakowanych tym opisem może stanowić zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa użytkownika i osób towarzyszących, a także może doprowadzić do uszkodzenia produktu.
	Znak oceny zgodności według odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw europejskich	
	Ostrzeżenie o postępowaniu zgodnie z Instrukcją obsługi i konserwacji produktu	

▪ Produkt

7. Ogólna budowa wózka

Wózek inwalidzki specjalny MOUSE in.basic składa się z dwóch głównych części: ramy wózka z siedziskiem i oparciem, podnóżkiem oraz bogatym wyposażeniem dodatkowym, które należy dobrać według indywidualnych potrzeb użytkowników.



- Stalowa rama.

Do elementów ramy wózka należą:

- 1-Regulowana, ergonomiczna rączka do pchania wózka -patrz 8.4
- 2-Koła skrętne -patrz 8.3
- 3-Hamulec -patrz 8.3
- 4-Zaczepy ramy do siedziska -patrz 9.1
- 5-Regulacja wysokości ramy -patrz 9.2
- 6-Mechanizm składania ramy -patrz 8.1, 8.2

- Regulowane kątowno siedzisko terapeutyczne

Do jego elementów należą:

- Tapicerka siedziska wykonana z materiału syntetycznego
- 7-Wewnętrzna wkładka zwężająca i spływająca siedzisko -patrz 10.6
- 8-Regulowane kątowno oparcie -patrz 9.4
- 9-Mocowanie barierki -patrz 10.2
- 10-Barierka zabezpieczająca -patrz 10.2
- 11-Pasy pięciopunktowe -patrz 10.1
- 12-Klin -patrz 10.5

13- Peloty zagłówka z regulacją \leftrightarrow oraz \updownarrow -patrz 11.1

14- Regulowany daszek z okienkiem -patrz 10.3

15- Regulowany kątowno podnóżek -patrz 8.5

16- Przedłużki podnóżka -patrz 8.5

8. Konfiguracja i użytkowanie – rama wózka

8.1. Rozkładanie ramy wózka.

Złożoną ramę należy podnieść, a następnie rozłożyć podpory poprzeczne i dokręcić je pokrętkami gwiazdowymi znajdującymi się u podstawy ramy (patrz Zdj. 8.1.1).



Zdj. 8.1.1

W mechanizmie mocowania siedziska należy rozłożyć podpory poprzeczne, a następnie dokręcić pokrętkami gwiazdowymi do ramy głównej pionowej (patrz Zdj. 8.1.2, 8.1.3, 8.1.4, 8.1.5).



Zdj. 8.1.2



Zdj. 8.1.3



Zdj. 8.1.4



Zdj. 8.1.5

Wysokość rączki wózka należy dopasować według indywidualnych potrzeb opiekuna.

8.2. Składanie ramy. Blokada transportowa.

Przed złożeniem ramy należy zablokować hamulce oraz ustawić rączkę podstawy w pozycji „0”.

Aby złożyć ramę należy wyjąć siedzisko i ustawić wysokość ramy oznaczoną cyfrą 1. Następnie należy odkręcić pokrętło gwiazdowe mocowania siedziska w ramie i schować podpory poprzeczne w mocowaniu (patrz Zdj. 8.2.1).



Zdj. 8.2.1

Następnie należy odkręcić pokrętło gwiazdowe znajdujące się przy ramie wózka. Należy wyjąć śrubę zabezpieczającą, po czym złożyć odbezpieczone podpory do wewnątrz ramy składając przy tym powoli ramę (patrz Zdj. 8.2.2). Po złożeniu zamontować z powrotem śrubę zabezpieczającą i zablokować ramę blokadą transportową (patrz Zdj. 8.2.3).



Zdj. 8.2.2

UWAGA! Wózek służy do użytku domowego. Wózek może być używany na powierzchni płaskiej (brak dużych uskoków, progów).

UWAGA! Wszelkie regulacje wózka i jego elementów należy wykonywać BEZ DZIECKA umieszczonego w wózku! Niestosowanie się do powyższych ostrzeżeń grozi poważnym niebezpieczeństwem dla użytkującego dziecka!



Zdj. 8.2.3

8.3. Koła skrętne oraz indywidualne hamulce

Cztery niezależne koła pozwalają na łatwe manewrowanie na małych powierzchniach. Hamulce zapewniają stabilizację wózka podczas postojów i regulacji. Aby zablokować hamulce, należy ustawić blokadę zgodnie ze Zdj. 8.3.1. Aby odblokować hamulce, należy ustawić blokadę zgodnie ze Zdj. 8.3.2.



Zdj. 8.3.1 Zablockowane



Zdj. 8.3.2 Odblockowane

8.4. Ergonomiczna rączka do pchania wózka. Mechanizm i regulacja kątowa rączki.



Zdj. 8.4.1



Zdj. 8.4.2

Rączka do pchania wózka zapewnia pewny uchwyt w różnych warunkach jazdy. Posiada możliwość regulacji służącej do dopasowania wysokości uchwytu dla asystenta dziecka, który prowadzi wózek – Zdj. 8.4.1 i 8.4.2.

- **Mechanizm regulacji.**

Są to dwa przyciski po zewnętrznej stronie ramy, umieszczone na przegubach rączki do pchania wózka.

- **Regulacja kątowa rączki do pchania wózka**

W celu zmiany kąta pochylenia rączki do pchania wózka należy nacisnąć jednocześnie oba przyciski mechanizmu regulacji kątowej rączki do pchania i zmienić jej kąt pochylenia. Po ustawieniu rączki w odpowiedniej pozycji, należy przestać naciskać na przyciski, co spowoduje automatyczne zablokowanie rączki do pchania w żądanej pozycji.

8.5. Podnózek. Regulacja i użytkowanie.

- W celu zmiany pochylenia podnóżka, należy wcisnąć przyciski zaznaczone na zdjęciu po obydwóch stronach podnóżka, następnie ustawić odpowiednią pozycję i zwolnić przyciski (Zdj. 8.5.1).

- W celu zmiany wysokości podnóżka należy wykręcić śruby mocujące podnózek i wyciągnąć podnózek z łańcuchów. W miejsce podnóżka należy zamontować 2 przedłużki (rurki) i przykręcić śruby. Podnózek należy wsunąć do rurki dzięki czemu uzyskuje się dodatkowe 3 wysokości montażu podnóżka (patrz Zdj. 8.5.2).

Podnózek jest wyposażony w taśmy mocujące stopy dziecka. Zaleca się ich zakładanie podczas użytkowania wózka.



Zdj. 8.5.1
Przyciski do pochylania



Zdj. 8.5.2.
Śruby i przedłużki


9. Konfiguracja i użytkowanie -siedzisko terapeutyczne z oparciem na plecy

9.1. Montaż i demontaż siedziska do ramy

- **Montaż siedziska.** Siedzisko należy zamontować przodem do kierunku jazdy. W celu zamontowania siedziska:
 - a) należy zablokować hamulce, aby rama była stabilna i nieruchoma (patrz Zdj. 9.1.1).



Zdj. 9.1.1 *Dobrze*

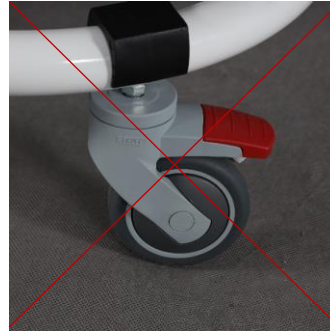

Źle

- b) należy nałożyć siedzisko w zaczepy ramy i docisnąć siedzisko, aż do dwóch kliknięć. O prawidłowym założeniu siedziska świadczą wyraźne dźwięki "klik", pochodzące z obu zaczepów podstawy siedziska (patrz Zdj. 9.1.2 i 9.1.3).



Zdj. 9.1.2



Zdj. 9.1.3

- **Demontaż siedziska.** W celu zdemontowania siedziska, należy wcisnąć w dół, w kierunku podłoża, po obu stronach wózka białe przyciski (patrz rysunek), znajdujące się u spodu obu zaczepów ramy. Następnie wysunąć siedzisko z zaczepów ramy.



9.2. Regulacja wysokości

Sześciostopniowa regulacja wysokości mocowania siedziska pozwala na dostosowanie położenia dziecka w siedzisku.

Mechanizm regulacji wysokości znajduje się na środku ramy. Aby zmienić wysokość ramy należy odblokować zacisk mimośrodowy znajdujący się po obu stronach wózka (skrzydełka powinny znajdować się po prawej stronie) (Zdj. 9.2.1), następnie dopasować wysokość (skala wysokości została opisana cyframi 1-6) (Zdj. 9.2.2 i 9.2.3).

UWAGA! Przed zablokowaniem mechanizmu należy upewnić się, że wysokość po obu stronach jest identyczna!



Zdj. 9.2.1



Zdj. 9.2.2



Zdj. 9.2.3

Zablokuj zacisk (skrzydełka powinny znajdować się po lewej stronie) (Zdj. 9.2.4) i dociśnij ramę, aby upewnić się, że mechanizm regulacji wysokości został prawidłowo zablokowany.



Zdj. 9.2.4

UWAGA! Wszelkie regulacje wózka i jego elementów należy wykonywać BEZ DZIECKA umieszczonego w wózku! Niestosowanie się do powyższych ostrzeżeń grozi poważnym niebezpieczeństwem dla użytkującego dziecka!

9.3. Regulowane siedzisko, tzw. "kołyska"

Wózek wyposażony jest w siedzisko, które można ustawić w 4 różnych pozycjach pochylenia (kołyska). W celu zmiany pochylenia siedziska należy pociągnąć w tył stalowy uchwyt umieszczony z tyłu siedziska i powoli zmieniać pochylenie siedziska. Po ustawianiu siedziska w pożądaną pozycję należy puścić uchwyt (Zdj. 9.3).

UWAGA! Każda zmiana pochylenia siedziska powoduje zmianę ogólnego środka ciężkości. Ma to wpływ na stabilność wózka.

UWAGA! Wszelkie regulacje wózka i jego elementów należy wykonywać BEZ DZIECKA umieszczonego w wózku! Niestosowanie się do powyższych ostrzeżeń grozi poważnym niebezpieczeństwem dla użytkującego dziecka!



Zdj. 9.3
Regulacja siedziska

9.4. Regulowane oparcie

Wózek wyposażony jest w oparcie, które można ustawić w różnych pozycjach pochylenia: od pozycji siedzącej do pozycji leżącej. W celu zmiany pochylenia oparcia w pierwszej kolejności należy je odciążyć, poprzez nieznaczne przesunięcie całego oparcia w kierunku pozycji bardziej siedzącej. Następnie należy pociągnąć do góry uchwyt umieszczony z tyłu oparcia i powoli zmienić pochylenie oparcia. Po ustawieniu oparcia w odpowiedniej pozycji, należy opuścić w dół uchwyt umieszczony z tyłu oparcia. **UWAGA! Każdorazowa zmiana pochylenia oparcia wymaga ponownej regulacji długości pasów pięciopunktowych! Regulacje należy wykonywać z włączonym hamulcem.**



Zdj. 9.4
Regulacja kąta oparcia

UWAGA! Wszelkie regulacje wózka i jego elementów należy wykonywać BEZ DZIECKA umieszczonego w wózku! Niestosowanie się do powyższych ostrzeżeń grozi poważnym niebezpieczeństwem dla użytkującego dziecka!

10. Wyposażenie podstawowe


10.1. Pasy pięciopunktowe

Wózek inwalidzki MOUSE in.basic jest standardowo wyposażony w profesjonalne, pięciopunktowe pasy bezpieczeństwa:

- **Regulacja pasów pięciopunktowych.** Przed założeniem dziecku pasów pięciopunktowych należy je wyregulować. W celu regulacji długości pasów należy przesunąć regulatory na szelkach w górę lub w dół i odpowiednio przesunąć ochraniacze. W celu regulacji wysokości zamocowania pasów do oparcia na plecy, należy przełożyć mocowanie szelek z mocowania niskiego na mocowanie wysokie lub odwrotnie.

- **Użytkowanie.** W celu założenia dziecku pasów pięciopunktowych, należy założyć dziecku szelki z prawej i lewej strony, a następnie wpiąć obie szelki w klamrę do zapinania pasów, która zamocowana jest na siedzisku. W celu ściągnięcia z dziecka pasów pięciopunktowych, należy nacisnąć przycisk na klamrze górnej (piersiowej) oraz dolnej i wypiąć obie szelki z klamry oraz powoli ściągnąć te szelki z prawej i lewej strony dziecka.

Uwaga! Każdorazowa zmiana kąta pochylecia oparcia na plecy wymaga ponownej regulacji długości pasów pięciopunktowych.

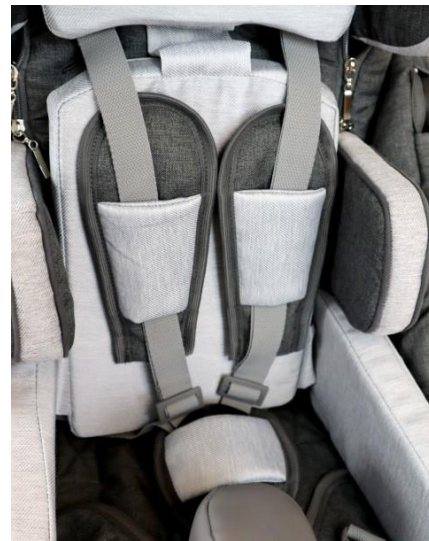

Zdj. 10.1.
Pasy pięciopunktowe

10.2. Barierka zabezpieczająca

Wózek inwalidzki MOUSE in.basic może być wyposażony w barierkę zabezpieczającą, która w przypadku określonych wskazań zapobiega wypadnięciu siedzącego dziecka do przodu.

- **Montaż i demontaż barierki.** Barierkę zabezpieczającą montuje się za pomocą tych samych mocowań, co stolik terapeutyczny, dlatego nie można użytkować obu tych elementów równocześnie. W celu montażu barierki zabezpieczającej należy wsunąć ją w mocowanie stolika lub barierki aż do kliknięcia.

Barierka będzie prawidłowo zamontowana dopiero wtedy, gdy zostanie prawidłowo wsunięta w mocowanie stolika lub barierki. Świadczy o tym wyraźny dźwięk "klik", pochodzący z dobrze połączonych mocowania stolika lub barierki.

W celu demontażu barierki należy nacisnąć dwa przyciski znajdujące się przy mocowaniu stolika lub barierki oraz wysunąć barierkę.



Zdj. 10.2
Barierka zabezpieczająca

10.3. Regulowany daszek z okienkiem

Wózek inwalidzki MOUSE in.basic może być wyposażony w regulowany daszek z okienkiem, który pomaga chronić dziecko przed słońcem lub deszczem. Elementami daszku są: stelaż daszku (przedni i tylny łuk), mechanizm regulacji otwierania daszku (prawy i lewy), dwa zatrzaski z czerwonymi przyciskami mocujące daszek do ramy, tapicerka daszku, oraz okienko z moskitierą z zamkiem błyskawicznym.

- **Montaż.** Mocowaniem regulowanego daszku z okienkiem są dwa plastikowe elementy znajdujące się na zewnętrznych bokach górnej części oparcia na plecy.

W celu montażu daszku należy ustawić oparcie na plecy w pozycji pionowej, a następnie równoległe nasunąć oba zatrzaski daszku do mocowań na oparciu na plecy. Daszek montujemy w taki sposób by tapicerka z tyłu/dołu zachodziła za plecy wózka.

- **Demontaż.** W celu demontażu daszku z okienkiem, należy nacisnąć dwa czerwone przyciski na zatrzaskach mocujących daszek oraz wysunąć te zatrzaski z mocowań na oparciu na plecy.

- **Użytkowanie.** W celu zmiany wielkości powierzchni daszka, należy chwycić za łuk przedni oraz łuk tylny stelaża daszka i przybliżając lub oddalając oba łuki od siebie lub do siebie, ustawić żądaną pozycję. Mechanizm regulacji wielkości powierzchni daszka zatrzaskuje się automatycznie.

Cechą szczególną daszka jest okienko z moskitierą zapewniające przewiew. Okienko otwiera się i zamyka za pomocą zamka błyskawicznego.



Zdj. 10.3

Regulowany daszek

10.4. Pasy odwodząco-stabilizujące



Zdj. 10.4

Pasy odwodząco-stabilizujące

Pasy odwodząco-stabilizujące służą do dodatkowej stabilizacji miednicy i zapobiegają wyślizgnięciu się dziecka z wózka. Prawidłowy sposób ich stosowania polega na takim zapięciu na udach dziecka, żeby jego miednica przylegała jak najbliżej oparcia na plecy. Zapewni to zdrowszą i bardziej komfortową pozycję dziecka w wózku.

- **Regulacja.** W celu regulacji długości pasów odwodząco-stabilizujących, należy przesunąć regulatory na przednich taśmach pasów w górę lub w dół.

- **Użytkowanie.** W celu założenia dziecku pasów odwodząco-stabilizujących należy posadzić dziecko na zamontowane pasy, następnie opleść nogę dziecka i zapiąć obie klamry pasów do obu taśm przednich. W celu ściągnięcia z dziecka pasów odwodząco-stabilizujących należy rozpiąć obie klamry pasów od taśm przednich.

10.5. Klin

Wózek inwalidzki MOUSE in.basic może być wyposażony w klin, który w przypadku określonych wskazań zapewnia odwodzenie (odchylenie na boki) kończyn dolnych dziecka od jego środka ciała. Klin posiada dwustopniowy poziom regulacji (patrz Zdj. 10.5).



Zdj. 10.5
Klin



Zdj. 10.6
Wkładki wyścielające

10.6. Wkładki wyścielające

Wózek MOUSE in.basic wyposażony jest we wkładki wyścielające, zabezpieczające rzepy na oparciu wózka, w przypadku, gdy nie są zakładane dodatkowe elementy wyposażenia (patrz Zdj. 10.6).

10.7. Tapicerka

Wózek MOUSE in.basic wyposażony jest w tapicerkę, która w całości jest demontowana do czyszczenia. W tym celu należy odpiąć wszystkie elementy mocujące ją do ramy wózka. Jak czyścić tapicerkę zostało opisane w pkt 16.7 Czyszczenie i pielęgnacja.

11. Wyposażenie dodatkowe

11.1. Peloty zagłówka z regulacją ↔ oraz ↕

W celu regulacji pelot zagłówka należy rozsunąć zapięcie tapicerki na przedniej i tylnej stronie oparcia. Następnie wykręć pokrętła (pokrętła od pelot), które znajdują się na tylnej stronie oparcia. Przełóż peloty w odpowiednie i bezpieczne dla dziecka miejsce na przedniej stronie oparcia. Dobrze przykręć peloty pokrętłami. Na koniec należy zasunąć zapięcie tapicerki na przedniej i tylnej stronie oparcia.




Zdj. 11.1.
Widok na wózek z pelotami

11.2. Peloty piersiowo-lędźwiowe z regulacją ↔ oraz ↕

W celu regulacji pelot piersiowo-lędźwiowych należy rozsunąć zapięcie tapicerki na przedniej (Zdj. 11.2.1) i tylnej stronie oparcia (Zdj. 11.2.2). Następnie należy wykręcić pokrętła (pokrętła od pelot, Zdj. 11.2.3), które znajdują się na tylnej stronie oparcia oraz przełożyć peloty w odpowiednie i bezpieczne dla dziecka miejsce na przedniej stronie oparcia. Peloty należy dobrze przykręcić pokrętłami. Na koniec zasunąć zapięcie tapicerki na przedniej i tylnej stronie oparcia (Zdj. 11.2.4).



Zdj. 11.2.1.
Rozpięcie tapicerki

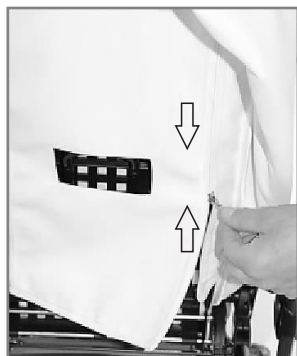

Zdj. 11.2.2.
Rozpięcie tapicerki



Zdj. 11.2.3.
Wykręcenie śrub



Zdj. 11.2.4.
Zapięcie tapicerki

11.3. Stolik terapeutyczny

Wózek wyposażony jest w antypoślizgowy stolik terapeutyczny, którego maksymalne obciążenie wynosi 3kg. W celu montażu stolika należy wsunąć go w mocowanie stolika lub barierki aż do kliknięcia.

Stolik będzie prawidłowo zamontowany dopiero wtedy, gdy zostanie prawidłowo wsunięty w mocowanie stolika lub barierki. Świadczy o tym wyraźny dźwięk "klik", pochodzący z dobrze połączonych mocowania stolika lub barierki.

W celu demontażu stolika należy nacisnąć dwa przyciski znajdujące się przy mocowaniu stolika lub barierki oraz wysunąć stolik.

Uwaga. Poziome ułożenie stolika może ulegać zmianie wraz z regulacją kołyski, a tym samym przedmioty umieszczone na stoliku muszą zostać zabezpieczone.



Zdj. 11.3
Stolik terapeutyczny

11.4. Wkładki zwężająco-sptycające

Wózek MOUSE in.basic wyposażony jest w zestaw wkładek zwężająco-sptycających (Zdj. 11.4). Służą one do regulacji wewnętrznych wymiarów szerokości i głębokości siedziska. Tapicerka wkładek jest zdejmowalna, co umożliwia ich wymianę lub czyszczenie.

- **Montaż.** Wkładki montujemy w dowolnym miejscu wózka, na dowolnej wysokości dostosowując się do wskazań pacjenta. Montaż odbywa się za pomocą rzepów na dolnej, tylnej i zewnętrznej stronie wkładki.

- **Demontaż** odbywa się poprzez ściągnięcie elementów – odrywając rzep od tapicerki wózka.



Zdj. 11.4
Wkładki zwężająco-sptycające

11.5. Moskitiera

Wózek inwalidzki MOUSE in.basic może być wyposażony w moskitierę, która utrudnia owadom bezpośrednią styczność z dzieckiem. Te wyposażenie dodatkowe wymaga montażu do innego wyposażenia dodatkowego. W celu montażu moskitiery należy połączyć ją zamkiem w budce, a następnie zasłonić moskitierą siedzisko wózka i podnóżek mocując z boku (Zdj. 11.5).



Zdj. 11.5

12. Specyfikacja techniczna wózka MOUSE in.basic

długość wózka	83,5 – 115,0 cm
szerokość wózka	58 cm
wysokość wózka	113,5 – 129,0 cm
masa całkowita	14,6 kg
efektywna głębokość siedziska	22* / 26 cm
szerokość siedziska	24* / 32 cm
wysokość oparcia	52 cm
szerokość oparcia	30 cm
odległość podnóżka od siedziska / ilość regulacji	ok 14,5-23 cm / 4 pozycje
długość wózka złożonego do transportu	rama 107 cm /siedzisko 72 cm
szerokość wózka złożonego do transportu	rama 57 cm /siedzisko 42 cm
wysokość wózka złożonego do transportu	rama 22 cm /siedzisko 39 cm
max. waga pacjenta	30 kg
wzrost pacjenta	80-110 cm
kąt płaszczyzny siedziska / ilość regulacji	ok 24°-42° / 4 pozycje
kąt pochylecia oparcia / ilość regulacji	ok 32°-90° / 4 pozycje + leżąca
kąt podnóżka / ilość regulacji	ok 84°-173° / 6 pozycji

*) z wkładką zwężająco-sptycającą

Tolerancja wartości pomiarów +/- 20mm, +/- 1,5kg, +/- 1°.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian parametrów technicznych.

12.1. Skład surowcowy wózka

Stal malowana proszkowo, tkaniny 100% poliester oraz tworzywo sztuczne (PP, PA, PU).

13. Dostawa i narzędzia

Wózek inwalidzki MOUSE in.basic jest dostarczany w kartonie i wstępnie zmontowany. W oryginalnym opakowaniu powinny znaleźć się następujące elementy:

- Złożona rama wózka z kołami wraz z siedziskiem i oparciem, podnózek, daszek
- Wyposażenie dodatkowe zgodne z zamówieniem
- Instrukcja obsługi wraz z kartą gwarancyjną.

Przed użyciem należy sprawdzić i upewnić się, że w otrzymanym kartonie znajdują się wszystkie elementy i żaden z nich nie uległ uszkodzeniu np. podczas transportu. W przypadku stwierdzenia, że w otrzymanym kartonie brakuje jakiegoś elementu lub jakiś element uległ uszkodzeniu, należy skontaktować się ze Sprzedawcą i/lub Producentem, w celu otrzymania brakujących elementów lub wymiany produktu na nowy, w pełni kompletny i sprawny.

Wielofunkcyjność oraz bogate wyposażenie wózka inwalidzkiego MOUSE in.basic pozwalają na dopasowanie wózka do osobistych wymagań użytkownika. W tym celu zapoznaj się dokładnie z całą instrukcją przed przystąpieniem do użytkowania.

Do montażu i demontażu wózka inwalidzkiego MOUSE in.basic nie są wymagane żadne narzędzia za wyjątkiem regulacji wysokości podnóżka, gdzie jest potrzebny śrubokręt krzyżakowy.

14. Montaż i demontaż wózka

- **Montaż wózka.** Produkt fabrycznie zapakowany w oryginalnym kartonie jest już wstępnie zmontowany. Należy dokończyć montaż poprzez wykonanie następujących czynności:

- a) rozłożyć ramę wózka wraz z siedziskiem regulując parametry:
 - wyregulować wysokość i kąt rączki do pchania wózka
 - ustawić kąt pochylenia siedziska
 - ustawić kąt pochylenia oparcia na plecy
 - wyregulować długość pasów pięciopunktowych
 - wyregulować wysokość podnóżka oraz kąt pochylenia podnóżka
- b) zamontować odpowiednie wyposażenie oraz wyregulować parametry, przykładowo:
 - wyregulować szerokość i głębokość użytkową siedziska (wkładki zwężająco-sptycające)
 - założyć barierkę bezpieczeństwa lub stolik terapeutyczny
 - wyregulować pasy odwodząco-stabilizujące
 - wyregulować daszek z okienkiem
 - założyć i wyregulować klin
 - założyć moskitierę

- **Demontaż wózka.** W celu demontażu wózka należy:

- a) zdemontować wyposażenie dodatkowe
- b) odpiąć siedzisko
- c) złożyć ramę zamykając ją blokadą transportową.

15. Przygotowanie do użytkowania

Przed rozpoczęciem użytkowania wózka należy:

- Sprawdzić stan techniczny wózka i wszystkich jego elementów, a jeżeli stan techniczny wózka lub jego pojedynczego elementu jest zły lub użytkownik ma do niego jakiegokolwiek wątpliwości,

- to wtedy wózka nie wolno użytkować. Prosimy o skontaktowanie się ze Sprzedawcą i/lub Producentem.
- Sprawdzić, czy rama wózka została prawidłowo rozłożona oraz czy mechanizm składania ramy został prawidłowo zamknięty (zablokowany).
 - Sprawdzić, czy siedzisko zostało prawidłowo zamontowane do ramy wózka oraz czy mechanizm mocowania siedziska do ramy wózka został prawidłowo zamknięty (zablokowany).
 - Sprawdzić sprawność działania hamulców i załączyć hamulce.
 - Prawidłowo dokonać wszystkich regulacji i dopasować wózek do potrzeb dziecka, w tym ustawić odpowiednią głębokość siedziska terapeutycznego i wysokość oparcia na plecy, odpowiednie pochylenie siedziska terapeutycznego i pochylenie oparcia na plecy, ustawić odpowiednie pochylenie podnóżka, wyregulować odpowiednią długość pasów pięciopunktowych. Sprawdzić, czy wszystkie elementy regulacyjne są właściwie osadzone i zabezpieczone.
 - Sprawdzić, czy tapicerka wózka jest sucha.
 - Zabezpieczyć dziecko wszelkimi dostępnymi elementami stabilizującymi, takimi jak: pasy pięciopunktowe, wkładki zwężająco-splycające, pasy odwodząco-stabilizujące, klin, podnóżek, taśmy podnóżka na stopy, barierka zabezpieczająca lub stolik terapeutyczny. Ma to na celu zabezpieczenie dziecka przed wypadnięciem i wysunięciem się z wózka oraz zabezpieczenie stóp dziecka przed spadnięciem z podnóżka. Upewnić się, że wykonane wcześniej wszystkie regulacje są dla dziecka odpowiednie i bezpieczne.
 - Zadbać, żeby dziecko nie było umieszczone w wózku bez odzieży osłaniającej ciało w miejscach kontaktu z tapicerką wózka. Ma to na celu przeciwdziałanie otarciom ciała dziecka oraz względy higieniczne dziecka.
 - W przypadku dzieci mających problem z trzymaniem moczu, należy położyć na siedzisko wózka specjalną ceratę, którą można nabyć w aptekach lub sklepach medycznych.
 - W przypadku stosowania wszelkich dodatkowych pomocy typu wenflony, dreny, worki, cewniki itp. należy zadbać, żeby były one dobrze zabezpieczone przed wypadnięciem, wyrwaniem, zaciśnięciem oraz nie przeszkadzały podczas użytkowania wózka.

16. Użytkowanie wózka

16.1. Przenoszenie wózka

Najlepszym sposobem przenoszenia wózka inwalidzkiego jest prowadzenie go z wykorzystaniem jego kół. W przypadkach, kiedy nie jest to możliwe (np. w celu transportu wózka w samochodzie), to ze względów bezpieczeństwa, wózek można podnosić i przenosić po uprzednim demontażu wyposażenia dodatkowego, w celu zmniejszenia ciężaru do przenoszenia.

Podczas przenoszenia lub podnoszenia ramy wózka, należy zachować szczególną ostrożność.

Podczas przenoszenia lub podnoszenia ramy wózka, należy złożyć ramę wózka, a następnie trzymać ramę wózka wyłącznie za wskazane elementy stałe ramy.

Ze względów bezpieczeństwa, nie należy podnosić całego wózka, czyli ramy z siedziskiem i z oparciem na plecy, podnóżkiem i zamontowanym wyposażeniem dodatkowym, ponieważ grozi to uszkodzeniem zdrowia.

Nie należy podnosić wózka chwytając za jego podnózek lub barierkę zabezpieczającą, stolik terapeutyczny ani żadne inne wyposażenie dodatkowe, ponieważ grozi to uszkodzeniem produktu i zagraża bezpieczeństwu innych osób z otoczenia.

16.2. Wsiadanie i zsiadanie z wózka inwalidzkiego

Przy wsiadaniu i zsiadaniu z wózka inwalidzkiego należy umieścić wózek jak najbliżej stabilnego i bezpiecznego miejsca, na które użytkownik będzie się przesiadał. Po upewnieniu się, że hamulce są załączone, a płyta podnóżka podniesiona jest do góry w celu uniknięcia stawania na niej, użytkownik może się przesiadać.

Nie wolno stawać na płycie podnóżka, ponieważ istnieje ryzyko przewrócenia wózka, urazu użytkownika i ryzyko uszkodzenia produktu.

Należy zwrócić uwagę, aby podczas wsiadania lub wysiadania z wózka, dziecko i żadna inna osoba nie stawały na podnóżku, ponieważ grozi to jego uszkodzeniem i urazem użytkownika!

16.3. Prawidłowa pozycja w wózku inwalidzkim

Z powodów bezpieczeństwa i zdrowotnych zaleca się, żeby użytkownik miał ułożone miednicę i plecy jak najbliżej oparcia, na ile to możliwe, w celu równomiernego podparcia kręgosłupa (optymalne podparcie wszystkich części kręgosłupa, tak by nie powstawała wolna przestrzeń).

Uda powinny mieć zapewnione podparcie na jak największej powierzchni, na całej swojej długości, czemu służy dopasowanie głębokości siedziska wózka, a stopy należy oprzeć na płycie podnóżka co zapobiega zsuwaniu się, utrzymuje optymalne napięcie mięśni nóg i przenosi część ciężaru z wyższych partii ciała.

UWAGA! Z uwagi na duże możliwości regulacyjne wózka, podczas regulacji kątowej siedziska i regulacji kątowej oparcia na plecy, istnieje możliwość ustawienia takiej pozycji, w której głowa dziecka znajdzie się poniżej linii miednicy. Zabronione jest stosowanie takiej pozycji, gdyż mogłoby to doprowadzić do niebezpieczeństwa zachłyśnięcia lub zakrztuszenia się dziecka.

16.4. Jazda na wózku inwalidzkim

Podczas użytkowania wózek zawsze należy trzymać za rączkę do pchania wózka, aby nie dopuścić do bezwładnego toczenia się wózka. Zwolnij hamulce jednocześnie trzymając rączkę do pchania wózka i popychaj wózek w bezpiecznym kierunku.

16.5. Pokonywanie progów

Zaleca się, aby niewielkie przeszkody (niewielkie progi lub wzniesienia) pokonywać tyłem. Inny sposób pokonywania progów może skutkować uszkodzeniem wózka. Jeżeli jest konieczność pokonania niewielkiej przeszkody przodem, należy przyblokować stopą specjalnie oznaczone miejsce na ramie i lekko pociągnąć do siebie rączkę do pchania wózka, żeby unieść przednie koła wózka i ostrożnie wjechać przednimi kołami na przeszkodę. Następnie powoli pociągnąć rączkę do pchania wózka do góry, w kierunku od podłoża, żeby unieść tylne koła wózka i ostrożnie wjechać tylnymi kołami na przeszkodę.

16.6. Transport w samochodzie i w innych pojazdach

- W celu przewiezienia wózka MOUSE in.basic w samochodzie należy zdemontować z wózka wszystkie akcesoria i przechować je w bezpiecznym miejscu. Następnie należy zdemontować wózek i umieścić go w bagażniku.

Jeśli zdemontowany wózek nie znajduje się w bagażniku samochodu oddzielonym od kabiny pasażerów, to należy dokładnie umocować ramę wózka inwalidzkiego do pojazdu. W tym celu można skorzystać z nieużywanych pasów bezpieczeństwa.

- W celu przewiezienia wózka inwalidzkiego w innych pojazdach, takich jak np. pociągi, tramwaje, autobusy, samoloty, statki, itp. należy zapytać osoby odpowiedzialne za transport w tych środkach komunikacji, o warunki bezpiecznej podróży do miejsca docelowego z wózkiem inwalidzkim oraz o stosowne wymagania.

- W celu przewiezienia wózka inwalidzkiego w innych pojazdach należy zdemontować z wózka wszystkie akcesoria i przechować je w bezpiecznym miejscu. Następnie należy zdemontować wózek (patrz rozdział 14) i umieścić go w miejscu przechowywania bagażu w danym pojeździe. Jeśli zdemontowany wózek nie znajduje się w bagażniku pojazdu oddzielonym od kabiny pasażerów, to należy dokładnie umocować ramę wózka inwalidzkiego do pojazdu.

Wózka MOUSE in.basic nie należy używać jako siedziska do przewożenia dziecka w pojeździe.

16.7. Czyszczenie i pielęgnacja

Tapicerkę można prać tylko ręcznie przy zachowaniu ostrożności, w temperaturze do 30°C.

Nie wolno prać w pralce. Plamy powinny być usunięte natychmiast po powstaniu na powierzchni wózka.

UWAGA! Nie wolno czyścić środkami chemicznymi zawierającymi rozpuszczalniki i wybielacze. Za szkody powstałe po zastosowaniu nieodpowiednich środków czystości Producent nie ponosi odpowiedzialności.

Nie ścieraj - ścieranie spowoduje rozprzestrzenienie się plamy na większą powierzchnię i może zniekształcić teksturę tkaniny oraz zniszczyć jej powłokę.

Upewnij się, że produkt jest zawsze suchy przed użyciem.



Prać tylko ręcznie



Nie wybielać



Nie suszyć w
suszarce bębnowej



Suszyć w pozycji
poziomej



Nie prasować

Postępowanie w przypadku wodnych plam, takich jak plamy z jedzenia, napojów i olejów roślinnych:

- Osusz plamę dociskając na całej jej powierzchni biały papierowy ręcznik, chusteczkę lub chłonną, czystą szmatkę.
- Mały kawałek szmatki nasącz słabym roztworem detergentu i ciepłej wody (lub zimnej wody w przypadku zabrudzeń krwią) i opłucz plamę usuwając ją od zewnątrz do środka, żeby uniknąć jej powiększania się. Nie używaj zbyt mokrej szmatki, gdyż nadmierna ilość cieczy może spowodować powstanie obwódki po wyschnięciu lub powiększenie się plamy i zniszczenie tapicerki lub pianki w jej wnętrzu.

- Może być konieczne powtórzenie powyższej czynności w zależności od rodzaju plamy i ilości zaplamionego materiału. Powyższą czynność należy kontynuować, aż do całkowitego usunięcia plamy, ale zawsze pamiętaj, żeby usunąć nadmiar wilgoci z zaplamionego materiału przed ponownym opłukiwaniem.
- Następnie należy opłukać materiał używając tylko letniej wody bez detergentu, za pomocą czystej gąbki lub czystej białej szmatki. Wysuszyć.

17. Przechowywanie wózka

Wózek należy przechowywać w czystym, suchym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu, najlepiej w temp 0-35°C.

17.1. Przygotowanie wózka do długotrwałego przechowywania

W celu przygotowania wózka inwalidzkiego MOUSE in.basic do długotrwałego przechowywania, należy zabezpieczyć produkt i wykonać wszystkie czynności serwisowe przedstawione w rozdziale "Przeglądy okresowe" tak, jakby nastąpił ich czas.

Wózek należy przechowywać w czystym, suchym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

17.2. Zabezpieczenie antykorozyjne

W celu uniknięcia uszkodzeń korozyjnych wózka, nie powinno się go użytkować ani zostawiać w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych.

Po zamoczeniu wózka, należy wytrzeć wszystkie zamoczone elementy miękką szmatką do sucha oraz zabezpieczyć środkiem konserwującym na bazie lekkiego oleju. Nie dotyczy to tapicerki wózka, której zapewnienie czystości i konserwacji opisane jest szczegółowo w rozdziale Czyszczenie i pielęgnacja. W razie uszkodzenia lakieru należy uszkodzenie zabezpieczyć poprzez nałożenie zaprawki przy użyciu proponowanego przez Producenta lakieru.

Regularne czyszczenie i smarowanie mechanizmów wózka lekkim olejem, gwarantuje długie i bezproblemowe użytkowanie wózka inwalidzkiego.

18. Powtórne użycie

Produkt nadaje się do powtórnego użycia.

Wszelkie produkty powtórnego użycia podlegają szczególnemu obciążeniu.

W związku z tym ich cechy i osiągi mogą odbiegać od produktu nowego w takim stopniu, że zagrożone jest bezpieczeństwo pacjentów i osób trzecich w trakcie ich użytkowania.

Produkt przy odpowiedniej pielęgnacji i konserwacji zachowuje swoją jakość przez okres 3 lat i tyle wynosi spodziewany okres jego użytkowania.

W celu wtórnego użycia należy:

- Zdemontować wszystkie elementy tapicerowane i wymienić je na nowe.
- Ramę wózka wraz z kołami i elementami do prowadzenia należy dokładnie wyczyścić i zdezynfekować dostępnymi na rynku środkami czyszczącymi i dezynfekującymi.
- Następnie produkt musi zostać sprawdzony przez autoryzowany Serwis (patrz rozdział 23) lub Producenta pod kątem zużycia i uszkodzeń.
- Wszelkie zużyte części oraz komponenty niepasujące lub nienadające się dla użytkownika należy wymienić na nowe.
- Tak przygotowany produkt może zostać ponownie wprowadzony do użycia.

19. Serwis i przeglądy okresowe

W celu bezpiecznego i bezawaryjnego korzystania z wózka inwalidzkiego MOUSE in.basic, należy regularnie i dokładnie poddawać go przeglądom i czynnościom serwisowym wskazanym poniżej.

W sytuacji, gdy użytkownik wózka nie jest w stanie samodzielnie przeprowadzić wymienionych czynności, powinien oddać wózek do specjalistycznego punktu serwisującego wózki inwalidzkie lub bezpośrednio do Producenta, który we właściwy sposób dokona przeglądu i niezbędnych czynności serwisowych. Czynności te mogą być dodatkowo płatne.

UWAGA! Producent odpowiada za wady lub uszkodzenia techniczne wózka powstałe wyłącznie przy prawidłowej eksploatacji wózka. Odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie wózka spoczywa na Producencie tylko w przypadku ścisłego stosowania się do wszystkich zaleceń Producenta.

UWAGA! Producent ponosi odpowiedzialność za właściwe funkcjonowanie wózka wyłącznie w przypadku zastosowania w nim oryginalnych części i oryginalnego wyposażenia dodatkowego.

Wszelkie naprawy należy przeprowadzać w wyspecjalizowanych, autoryzowanych Serwisach (patrz pkt 23) lub bezpośrednio u Producenta. Naprawy wózka wykonywane przez osoby inne niż autoryzowany Serwis lub Producenta spowodują utratę gwarancji. Producent nie odpowiada za uszkodzenia ciała lub zniszczenie produktu jakie mogą być konsekwencją naprawy wykonywanej przez osoby inne niż autoryzowany Serwis lub Producent.

Producent ponosi odpowiedzialność za właściwe funkcjonowanie wózka wyłącznie w przypadku jego zakupu w wyspecjalizowanym sklepie medycznym.

Czynności serwisowe należy wykonywać:

- **Każdorazowo przed użyciem wózka**

- Kontrola sprawności hamulców - Po załączeniu hamulca koła wózka powinny być zablokowane i nie mogą się obracać.
- Kontrola zamocowania elementów konstrukcyjnych - Należy skontrolować wszystkie mechanizmy wózka i jego elementy ruchome, a w szczególności należy zwrócić uwagę na: prawidłowe zamontowanie siedziska terapeutycznego z oparciem na plecy do ramy wózka, prawidłowe zamontowanie wszystkich czterech kół, prawidłowe funkcjonowanie pięciopunktowych pasów bezpieczeństwa, prawidłowo zablokowany mechanizm regulacji kątowej siedziska, prawidłowo zablokowany mechanizm regulacji kątowej oparcia oraz prawidłowe zamontowanie podnóżka.
- Kontrola stanu ogumienia - Należy sprawdzić czy ogumienie wszystkich czterech kół nie jest uszkodzone lub zużyte
- Kontrola stałych elementów ramy, siedziska z oparciem i stelaża podnóżka - Należy wzrokowo skontrolować stan profili konstrukcyjnych. Elementy te nie mogą być uszkodzone lub pęknięte.

- **Co każdy jeden miesiąc**

- Czyszczenie wózka -Należy oczyścić miękką szmatką wszelkie elementy ruchome, łożyska, mechanizmy regulacyjne, a następnie nasmarować je kilkoma kroplami lekkiego oleju. Zaleca się ostrożność, żeby nie ubrudzić tapicerki wózka lub własnego ubrania

- Kontrola wszystkich połączeń śrubowych pod kątem luzów - Należy dokładnie sprawdzić prawidłowe dokręcenie wszystkich śrub i pokręteł znajdujących się w wózku.

- **Co każde sześć miesięcy**
 - Sprawdzenie czystości tapicerki i sprawdzenie ogólnego stanu wózka - Nie należy dopuszczać do zaniedbania wózka, zgodnie z opisem w rozdziale "Czyszczenie i pielęgnacja"
 - Sprawdzenie stanu ogólnego wózka. Nie należy dopuszczać do zaniedbania wózka.

20. Utylizacja

Utylizacja i recykling: zużyty wózek należy oddać do punktu zajmującego się recyklingiem zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju.

21. Zgodność z wymaganiami dotyczącymi wyrobów medycznych

Wyrób Medyczny klasy I zgodny z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017r. w sprawie wyrobów medycznych. Na wyrób producent wystawił stosowną deklarację zgodności, która znajduje się na stronie www.mywam.eu

22. Notatki

23. Lista autoryzowanych punktów serwisowych

POLSKA

MyWam Kupiec, Bartold, Angres Spółka Jawna

ul. Szczecińska 10, 41-516 Chorzów, Polska

tel: +48 32 733 11 31

strona internetowa: www.mywam.eu

adres e-mail: mywam@mywam.pl

24. Karta Gwarancyjna

Seria i numer:

Data zakupu: - -

Pieczęć i podpis sprzedawcy:

Warunki gwarancji:

- Producent udziela nabywcy na zakupiony wózek gwarancji, na okres 24 miesięcy, licząc od dnia zakupu. Ujawnione w tym okresie wady będą usuwane bezpłatnie.
- Nabywca reklamujący wózek powinien dostarczyć wózek do Sprzedawcy lub do Producenta na własny koszt w opakowaniu wraz z zabezpieczonymi przed uszkodzeniem elementami wózka.
- Uszkodzenia spowodowane niedostatecznym zabezpieczeniem przesyłki wózka i jego elementów nie podlegają naprawom gwarancyjnym.
- Reklamujący nie może żądać gratyfikacji, jeżeli niewłaściwie oznakuje lub nieprawidłowo ubezpieczy przesyłkę wózka i jego elementy.
- Okres gwarancji wydłuża się o czas naprawy wózka.
- Czynności przewidziane w instrukcji, do których wykonania zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt, nie mogą być wykonane w ramach naprawy gwarancyjnej.
- Użytkowanie wózka powinno odbywać się zgodnie z niniejszą instrukcją obsługi.
- Użytkowanie wózka niezgodne z przeznaczeniem, niezgodne z niniejszą instrukcją obsługi lub niezgodne z zasadami prawidłowej eksploatacji powoduje utratę gwarancji.
- Dokonywanie jakichkolwiek zmian konstrukcyjnych wózka powoduje utratę gwarancji.
- Uszkodzenia wózka powstałe na skutek: niewłaściwej eksploatacji, niewłaściwej konserwacji, nieprawidłowego przechowywania wózka, uszkodzeń mechanicznych oraz naturalnego ścierania i zużywania się części (np. tapicerka, koła) nie podlegają gwarancji. Ich naprawa odbywa się na koszt użytkownika.
- Producent przestrzega przed dokonywaniem napraw gwarancyjnych w nieautoryzowanych zakładach serwisowych. Stwierdzenie takiej naprawy lub samowolnej przeróbki wózka powoduje utratę gwarancji.
- Karta gwarancyjna jest ważna pod warunkiem, że posiada: wpisaną datę sprzedaży potwierdzoną pieczęcią firmową Sprzedającego, podpis Sprzedającego, rodzaj i numer fabryczny wózka.
- Karta gwarancyjna jest ważna pod warunkiem, że nie zawiera skreśleń i poprawek.
- Producent wózka prowadzi jego odpłatny serwis pogwarancyjny.
- W sprawach nieuregulowanych niniejszą kartą gwarancyjną mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
- Wszelkie sprawy związane z gwarancją i reklamacją wózka proszę kierować do Sprzedawcy lub bezpośrednio do Producenta.